


ELEKTROPHOTONISCHE EMISSIONSPRÜFUNG


GLEICHES WASSER

VOR DER VITBOT FLASCHE

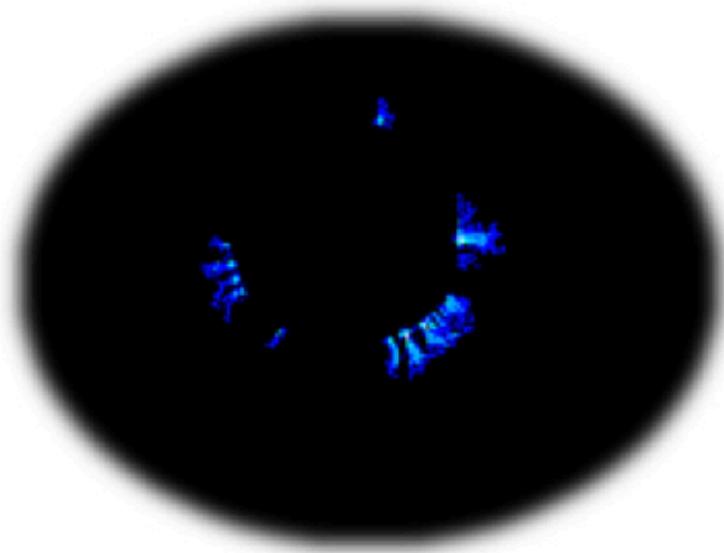

NIEDRIGE ENERGETISCHE QUALITÄT

NACH DER VITBOT FLASCHE

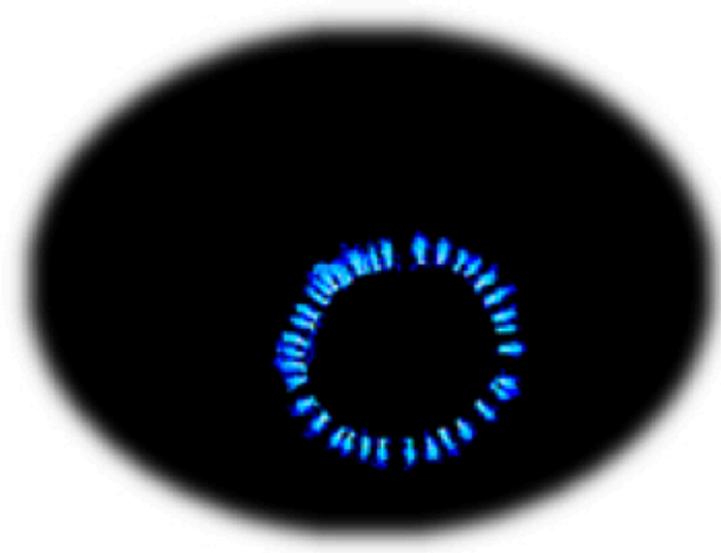

HOHE ENERGIEQUALITÄT

VON FLUIR AUFGENOMMENE UND ZERTIFIZIERTE BILDER. KAMERA GDV.
AUTHORIZED LAB. FÜR DR. KONSTANTIN KOROTKOV